



La confianza  
se puede diseñar

---

thermage®  
CPT SYSTEM

# La confianza es algo hermoso

---



ANTES DE THERMAGE

Tratamiento por Ivan Rosales, DM



3 MESES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO



ANTES DE THERMAGE

Tratamiento por Bil Johnson, DM



6 MESES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO



ANTES DE THERMAGE

Tratamiento por Ivan Rosales, DM



3 MESES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO



ANTES DE THERMAGE

Tratamiento por el Centro de Solta  
Medical Aesthetic



4 MESES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

# Practicar la confianza



## Introduciendo el nuevo sistema CPT Thermage. Resultados notables, en mayor comodidad

Nuestra tecnología única y líder en la industria ha sido el patrón de oro en el endurecimiento de la piel durante años. Por eso mismo estamos orgullosos de introducir el nuevo Sistema CPT Thermage, un salto adelante en la eficacia y comodidad del tratamiento.

El núcleo del sistema es la tecnología la que le permite entregar más calor terapéutico, de manera cómoda, para mejores resultados.

El sistema CPT Thermage aprovecha nuestra Tecnología Comfort Pluse patentada y una nueva pieza de mano vibradora:

- **Resultados hermosos** consistentes. Cuando se entrega calor uniforme en la zona de trabajo
- **Mayor comodidad** durante el procedimiento gracias a una mejora en nuestra Tecnología Comfort Pluse patentada
- **Mayor satisfacción del paciente** con un tratamiento más cómodo experiencia y mejores resultados


*"El Sistema CPT Thermage otorga una significativa mejora en la comodidad. Esto es muy importante porque cuando realizo un tratamiento quiero que mis pacientes regresen para futuros procedimientos. Con esta nueva tecnología, el 100% de los pacientes respondieron "Sí" para un procedimiento futuro."*

**Dr. Hector Leal, Monterrey, Mexico**


# Comfort

## Una significativa mejora en la comodidad de los pacientes

**Nuestro nuevo algoritmo de entrega de energía** entrelaza la entrega de radiofrecuencia pulsada con ráfagas de enfriamiento que imitan la terapia de estimulación del nervio eléctrico transcutáneo ("TENS"), para interrumpir la respuesta neuronal del cerebro y mejorar la comodidad del paciente durante el tratamiento.

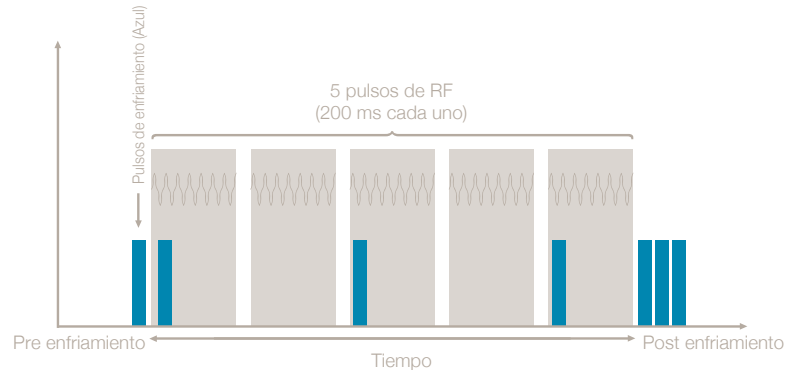

## Mejora en la comodidad

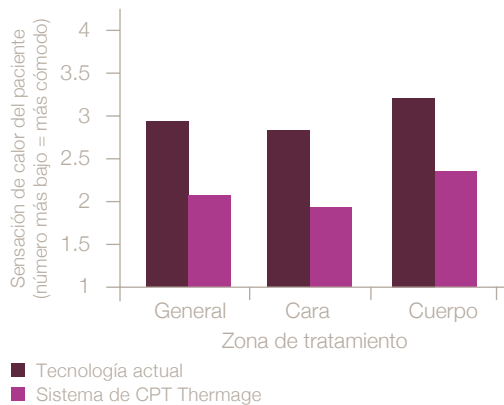

\*Basado en datos de estudios clínicos

**Una nueva pieza de mano vibradora** que ofrece una mejora probada clínicamente para la comodidad del paciente.


En unos ensayos clínicos a dos caras controlados se comparó la respuesta de 40 pacientes ante un tratamiento con vibración y ante un tratamiento sin vibración. Todos los pacientes prefirieron ser tratados con vibración.

Nuestra tecnología de vibración se apoya en la **Teoría de la Compuerta** (Melzack y Wall, 1965). Esta teoría sostiene que la estimulación no nociva en zonas de malestar puede disminuir el dolor. La aplicación del tacto en estas zonas puede estimular fibras nerviosas de gran diámetro. Estas fibras de gran diámetro entonces bloquean la actividad de las fibras de pequeño diámetro de llevar impulsos de incomodidad al cerebro.

# Eficacia

**Nuestras puntas de tratamiento rediseñadas** otorgan una mejora en la distribución y uniformidad del calor, lo que permite mejorar el calentamiento volumétrico. Se calienta un mayor volumen de tejido para alcanzar las temperaturas deseadas y el calentamiento se distribuye de manera más uniforme en toda la zona de tratamiento. Los datos de nuestro estudio clínico demuestran que el Sistema CPT Thermage calienta cuatro veces más tejidos a temperaturas terapéuticas que las tecnologías actuales.

## Mejora en la distribución y uniformidad del calor

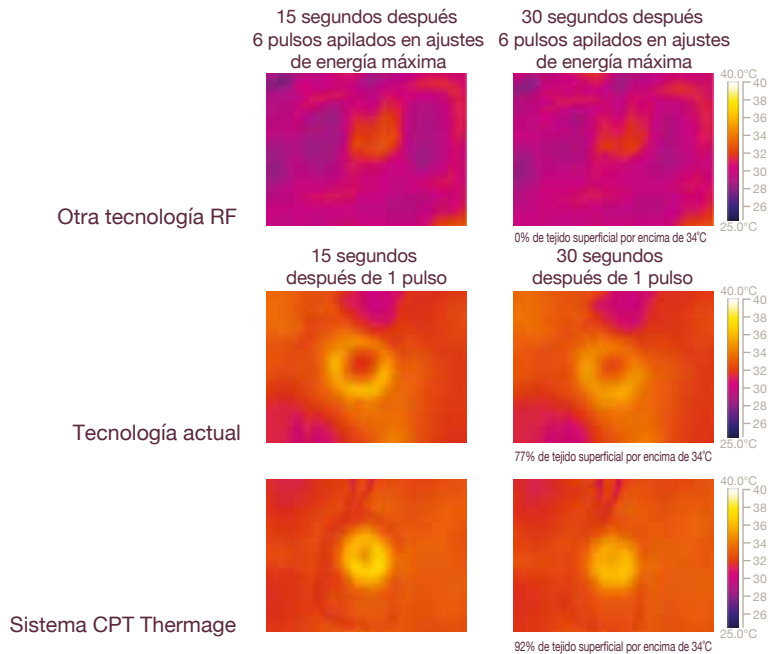

Una comparación de pulsos en el tejido del abdomen en vivo demuestra la superioridad del sistema Thermage CPT en la administración uniforme de calor y el calentamiento profundo del tejido

**Los pacientes estarán más contentos** con los resultados y con la experiencia del tratamiento con el Sistema CPT Thermage.

El 100% de los pacientes del estudio prefirieron el tratamiento Sistema CPT Thermage antes que los tratamientos con tecnologías anteriores.

Las puntuaciones promedio de satisfacción de los pacientes 3 meses después del tratamiento fueron 4,2 de 5 (1=insatisfecho, 5=muy satisfecho).

# Satisfacción del paciente



# TECNOIMAGEN

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 11-4582-2222

All Before and After photos are un-retouched and represent patients who have had significant results. Results vary depending on age and skin condition.

FDA cleared for the non-invasive treatment of wrinkles and rhytids, including the upper and lower eyelids. FDA cleared for the temporary improvement in the appearance of cellulite when combined with vibration.

Side effects are generally mild and may include redness, swelling, blisters, bumps and rare instances of surface irregularities.

© 2009 Solta Medical, Inc. All rights reserved. Thermage, Thermage CPT and Comfort Pulse Technology are trademarks or registered trademarks of Solta Medical, Inc.

MK2086