

APOLEX Tite

TECNOLOGÍA DE CONTORNO RF FACIAL Y CORPORAL

APOLEX Tite

TECNOLOGÍA DE CONTORNO RF FACIAL Y CORPORAL

Los tratamientos de contorno modernos requieren cada vez más tecnologías capaces de favorecer la contracción del tejido blando, la retracción cutánea y una transición de contorno uniforme en aplicaciones faciales y corporales.

APOLEX TITE está diseñado para favorecer procedimientos de RF subdérmica de precisión mediante un flujo de tratamiento optimizado. La plataforma favorece la tensión tisular, la contracción del tejido blando, la retracción cutánea y una transición de contorno uniforme en una amplia gama de aplicaciones de contorno facial y corporal.



Aplicaciones:

Faciales

- Párpado
- Línea mandibular
- Cuello
- Submentón
- Surco nasolabial

Corporales


- Abdomen
- Contorno de brazos
- Muslo
- Retracción cutánea posliposucción




Rostro



Ojo

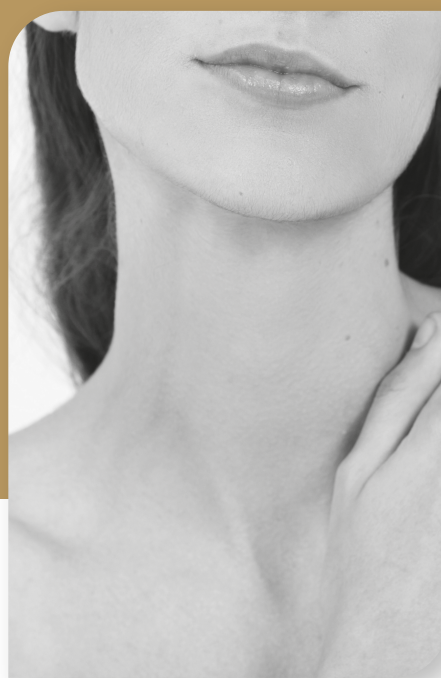

Cuello

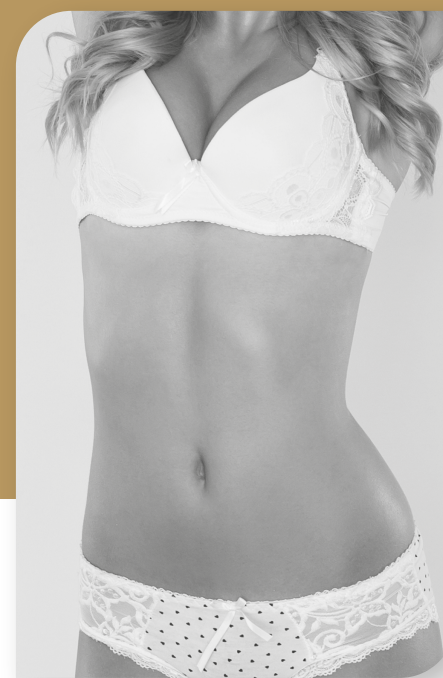

Cuerpo



Abdomen

Donde la innovación redefine los resultados,
Redefina el contorno con tecnología de precisión.

FLUJO DE TRABAJO DE RETRACCIÓN POR APOLEX TITE™


Acceso con cánula




Administración precisa de RF




Monitoreo tisular en tiempo real

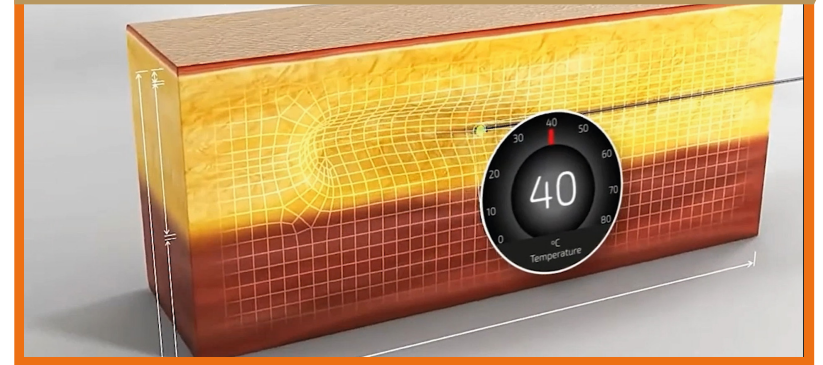

Contracción del tejido blando

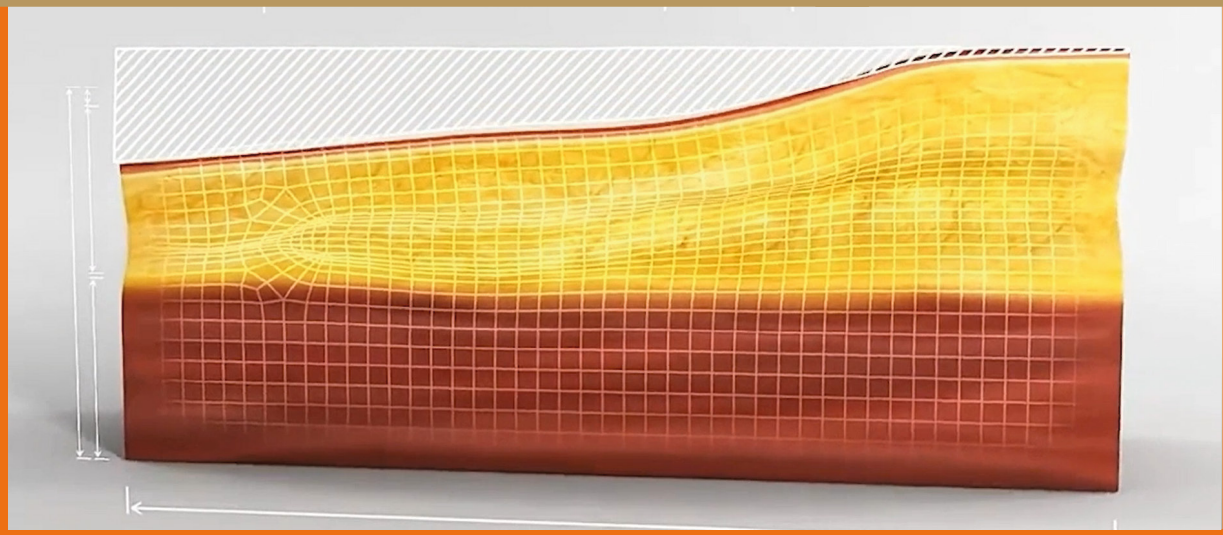

Retracción cutánea

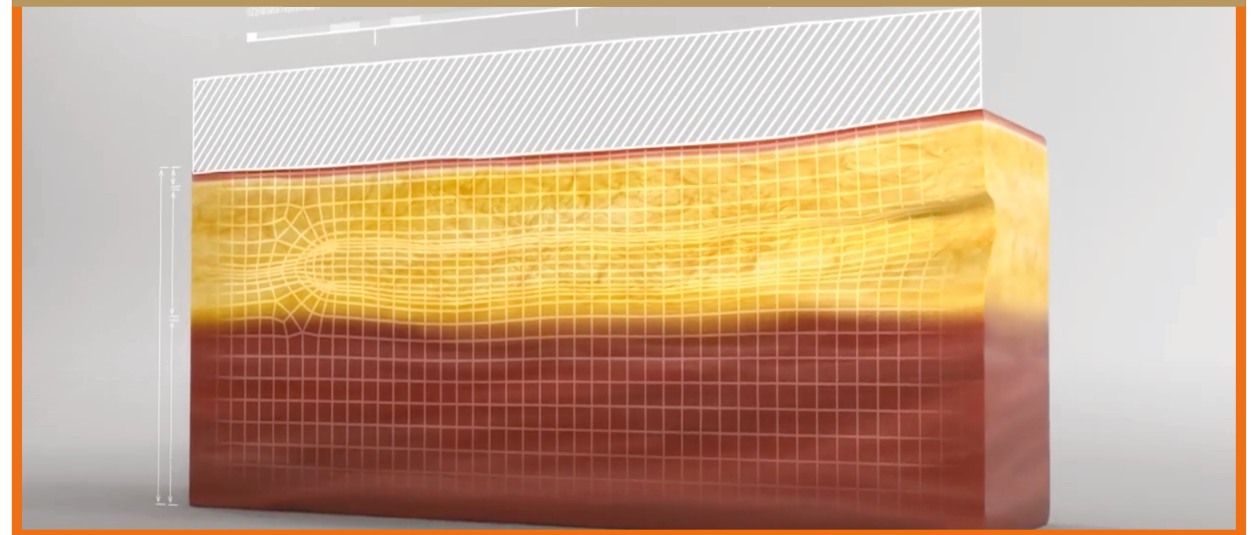

TECNOLOGÍAS PRINCIPALES DE APOLEX TITE™

Los procedimientos de RF interna de precisión requieren un monitoreo tisular continuo y una administración de RF sensible a la impedancia durante todo el tratamiento.


Al combinar el Monitoreo de Temperatura en Tiempo Real con la Administración de RF Sensible a la Impedancia, APOLEX favorece:

- Administración precisa de RF.
- Respuesta térmica consistente.
- Contracción del tejido blando.
- Retracción cutánea.

Tecnología Principal 01 Monitoreo de Temperatura en Tiempo Real

Monitoreo continuo de la temperatura tisular, diseñado para favorecer una respuesta térmica uniforme durante todo el procedimiento.

Este enfoque de monitoreo favorece una respuesta tisular consistente en las distintas áreas de tratamiento y estructuras de tejido.

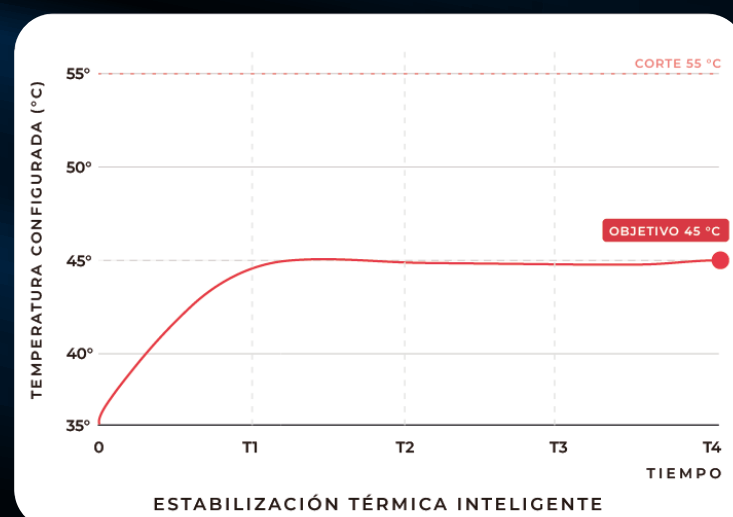


Tecnología Principal 02

Administración de RF Sensible a la Impedancia

APOLEX adapta continuamente la administración de RF según las características de impedancia del tejido durante el tratamiento, favoreciendo una administración precisa de RF y una respuesta tisular predecible.

Este enfoque de RF sensible a la impedancia favorece:

- Contracción del tejido blando
- Respuesta térmica consistente
- Retracción cutánea posprocedimiento
- Respuesta tisular predecible

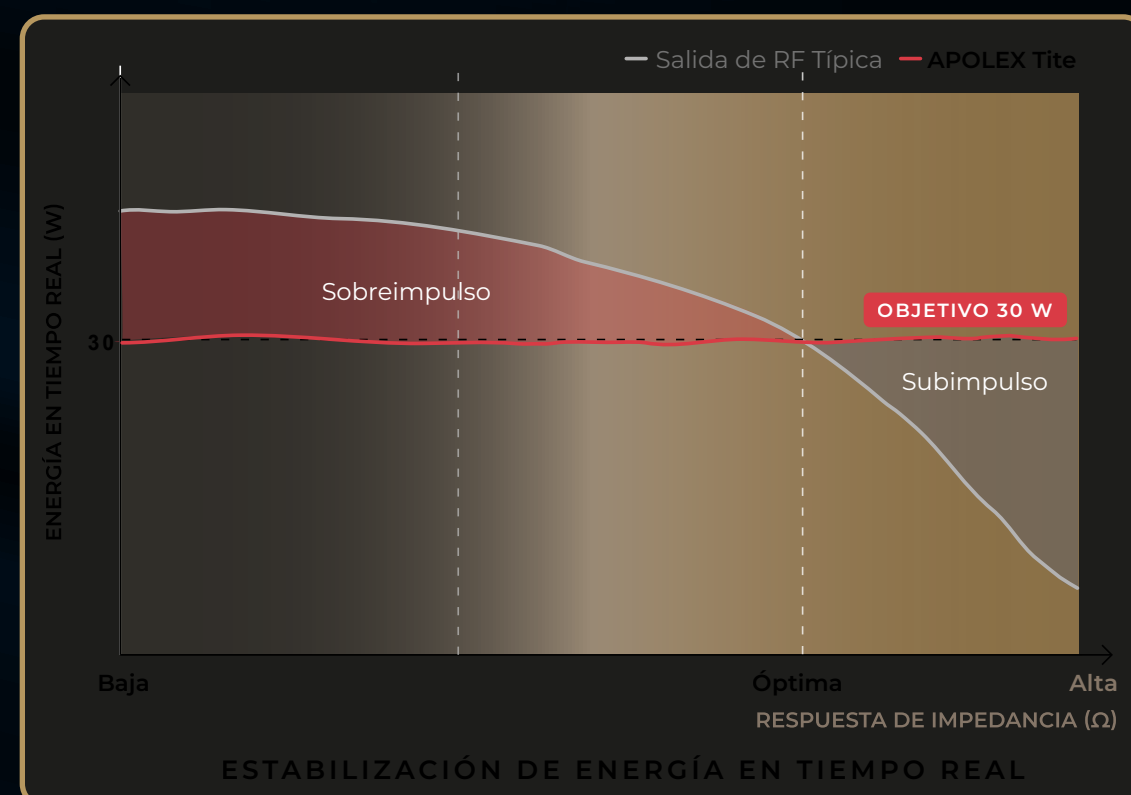

Sistema de Cánulas APOLEX- MULTIAPLICACIÓN

El sistema de cánulas APOLEX está diseñado para ofrecer un acceso preciso en múltiples áreas de tratamiento facial y corporal.

Las configuraciones especializadas de cánula favorecen:


- Contracción del tejido blando
- Procedimientos de remodelación tisular
- Retracción cutánea posprocedimiento

“Diseñada para ofrecer versatilidad en las aplicaciones de remodelación de tejido facial y corporal.”

Con tecnología:

eMulsify


reTraction

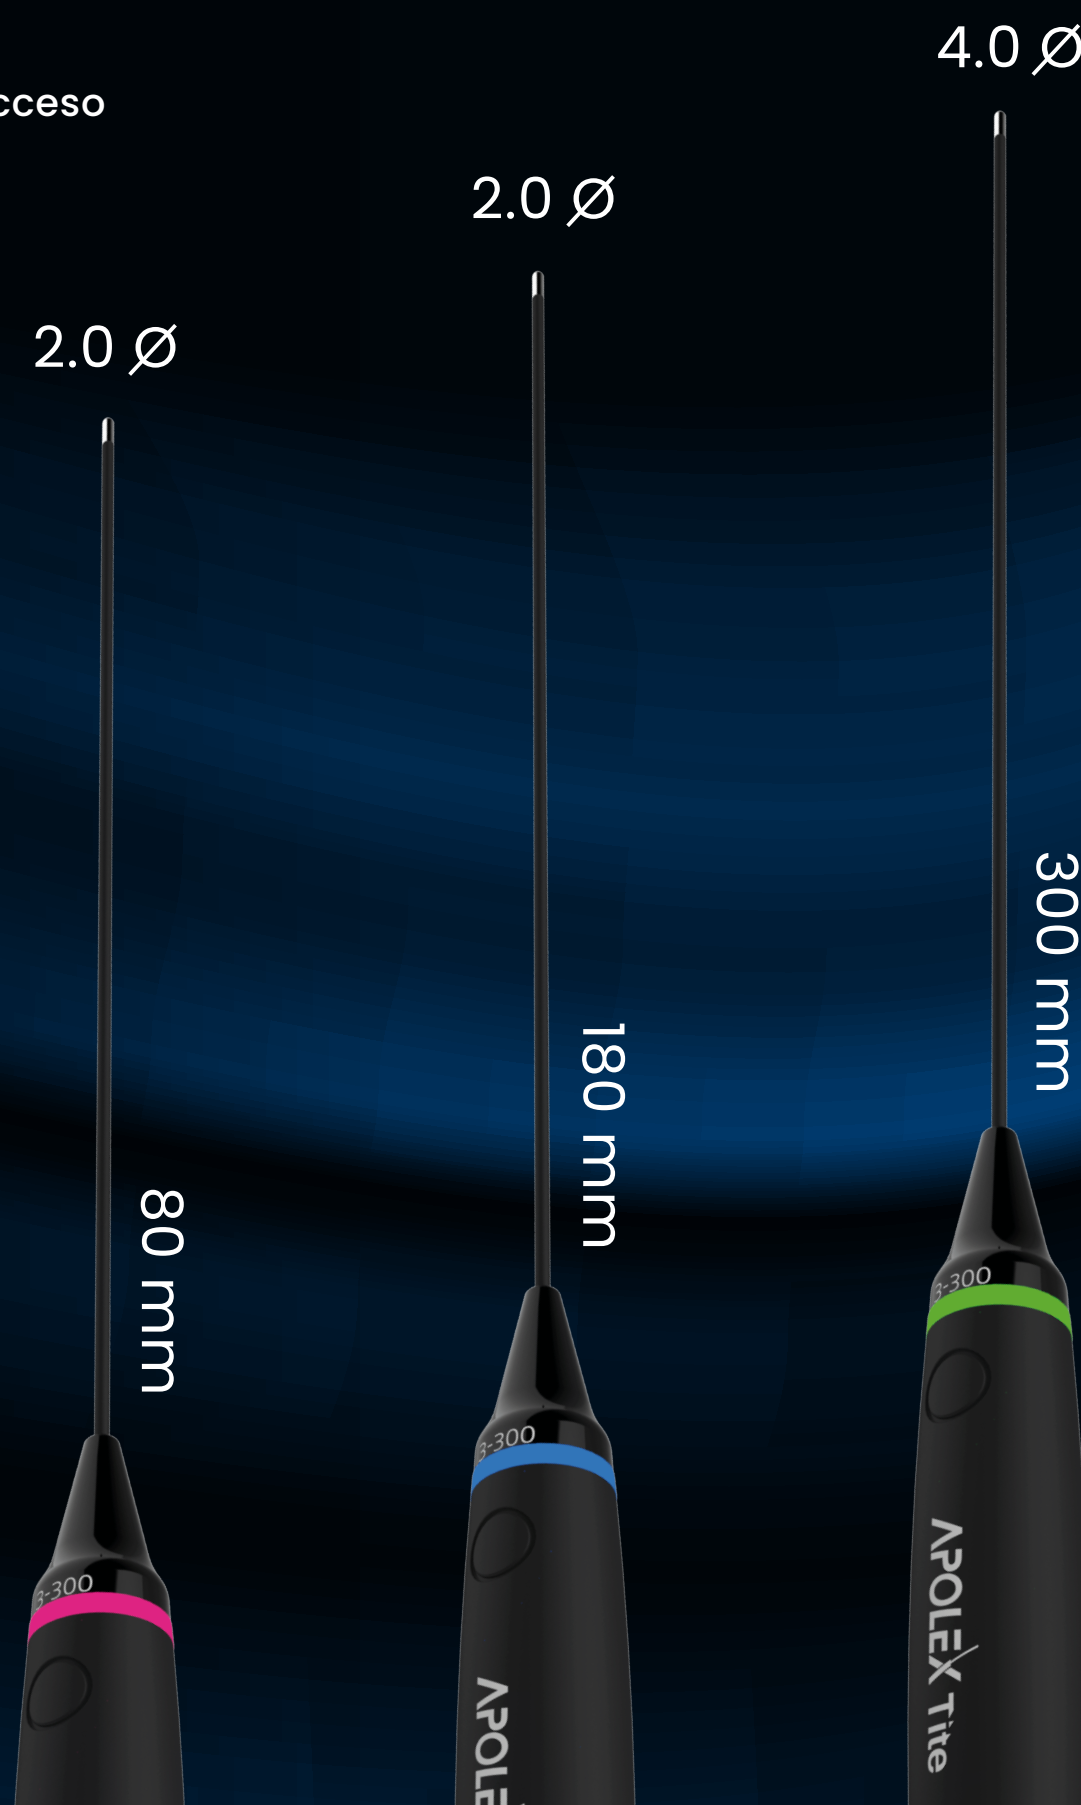

RESULTADOS DE RETRACCIÓN POR APOLEX TITE™

TECNOLOGÍA DE CONTORNO RF FACIAL Y CORPORAL

Antes

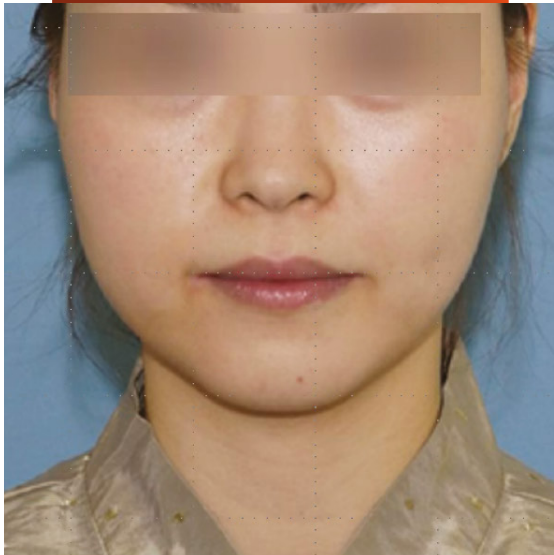


Dr. Jong-Hak Lim

Después




Cánula de pieza de mano 2Ø / Cronograma: 4 semanas. Reducción de tamaño, aumento de la elasticidad cutánea.

Antes

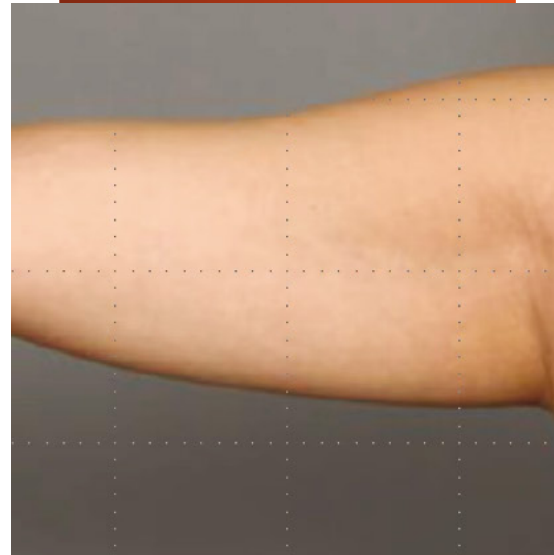


Dr. Jae-Ho Cho

Después

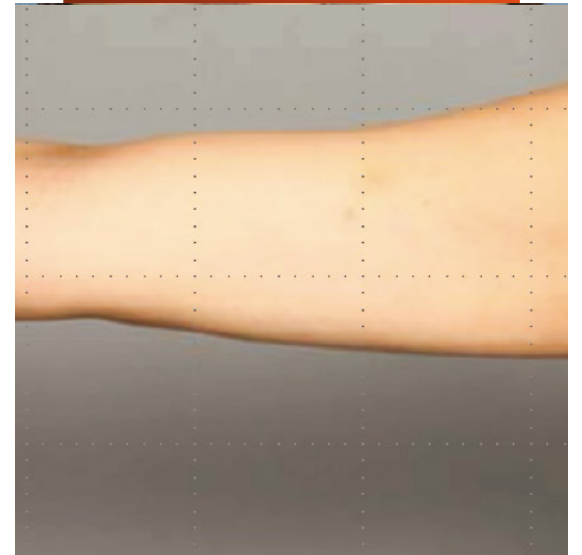


Cánula de pieza de mano 2Ø / Cronograma: 4 semanas. Reducción de tamaño, aumento de la elasticidad cutánea.

Antes

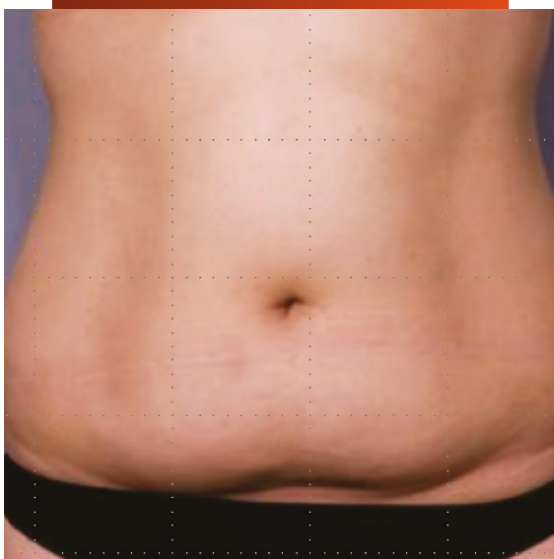


Dr. Jong-Hak Lim

Después

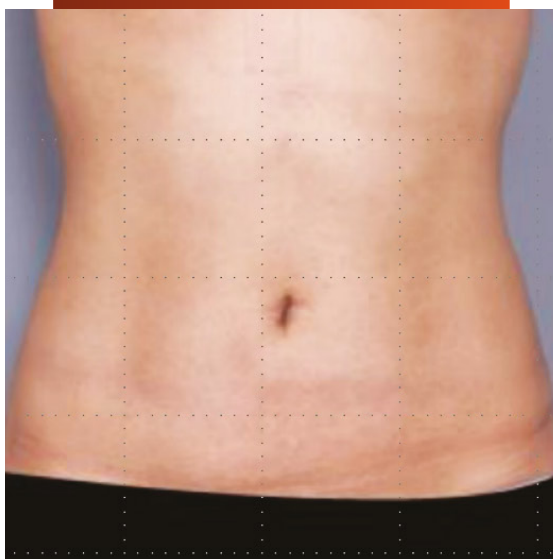

Cánula de pieza de mano 4Ø / Cronograma: 4 meses. Reducción de tamaño, aumento de la elasticidad cutánea.

Antes

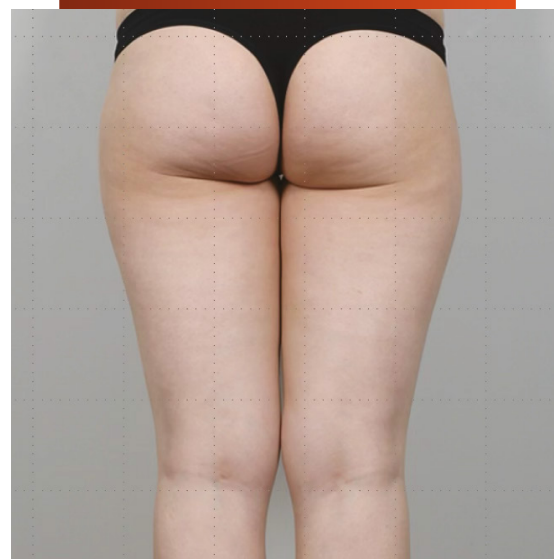

Dr. Jong-Hak Lim

Después



Cánula de pieza de mano 4Ø / Cronograma: 4 meses. Reducción de tamaño, aumento de la elasticidad cutánea.

RETRACCIÓN POR

APOLEX Tite™

Redefina el contorno. Recupere la confianza.

Esculpido desde el interior

La tecnología de RF interna de precisión favorece la contracción del tejido blando y la retracción cutánea posprocedimiento mediante una administración controlada de RF.

Siempre bajo control

La estabilización térmica en tiempo real y la administración de RF sensible a la impedancia favorecen una respuesta tisular consistente durante todo el tratamiento.

Una sola plataforma, múltiples aplicaciones.

Compatible con una amplia gama de aplicaciones de contorno facial y corporal.



APOLEX^{Tite}

SMART RF LIPOLYSIS DEVICE

